


# 大声測定器 SI-204 簡易取扱説明書

① 本器は次の内容で写真の様に梱包しております。



大声測定器 SI-204 …1台  
付属品は本器内部に同梱


また本器は表と裏を留め具で固定しており、内部に電源ケーブルとリセットケーブルを収納しております。

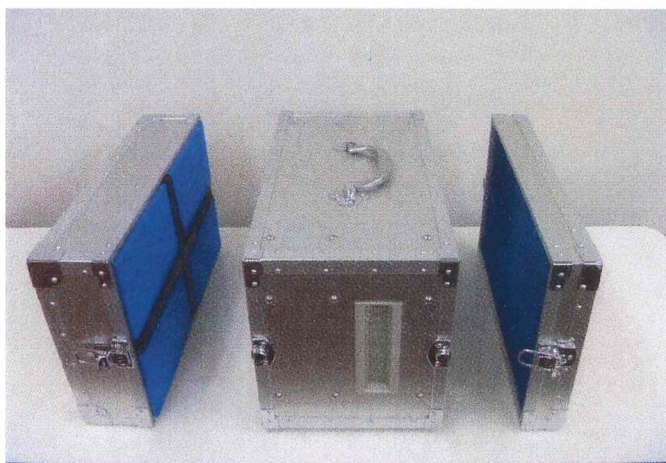

中央下、右: マイク、ウレタン風防  
マイクホルダ、ケーブル10M

左: リセットケーブル  
中央上: 電源ケーブル

② ケーブルを接続します。

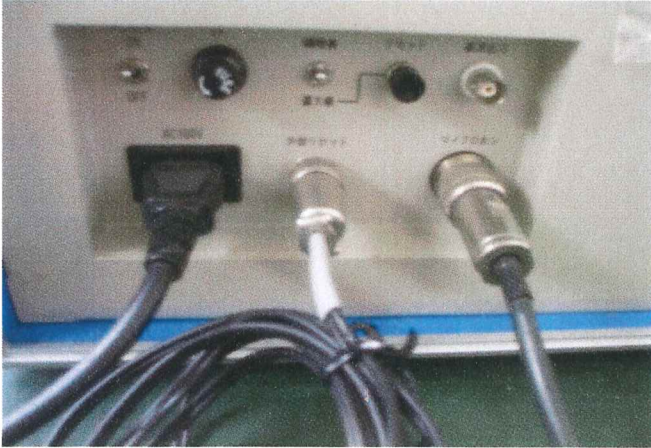

- 左側… 電源ケーブル(AC100V)  
家庭用電源で結構です。
- 中央… リセットケーブル  
最大値の解除を行います。
- 右側… マイクケーブル  
差し込み後、コネクタを回して  
固定して下さい。



左図の様に三脚に固定して下さい。

- ※ 三脚はユーザー様にてご用意願います  
市販品でご使用可能です。

③ 左上部にある主電源スイッチをONにします。



**使用時の注意**

本器は最大値を表示しており、測定中に  
数値が更新されると連動致します。  
初期値に戻すにはリセットボタンを押して  
下さい。

- ※ 使用時はウレタン風防を取り付けたままお使い下さい。  
水滴やツバ、塵が入りますと故障の原因となります。

④ ご使用後はケーブルを外し、送付しました箱に収納してご返却願います。